




Alguns dos seus pacientes faz isso
2.000 vezes por ano?



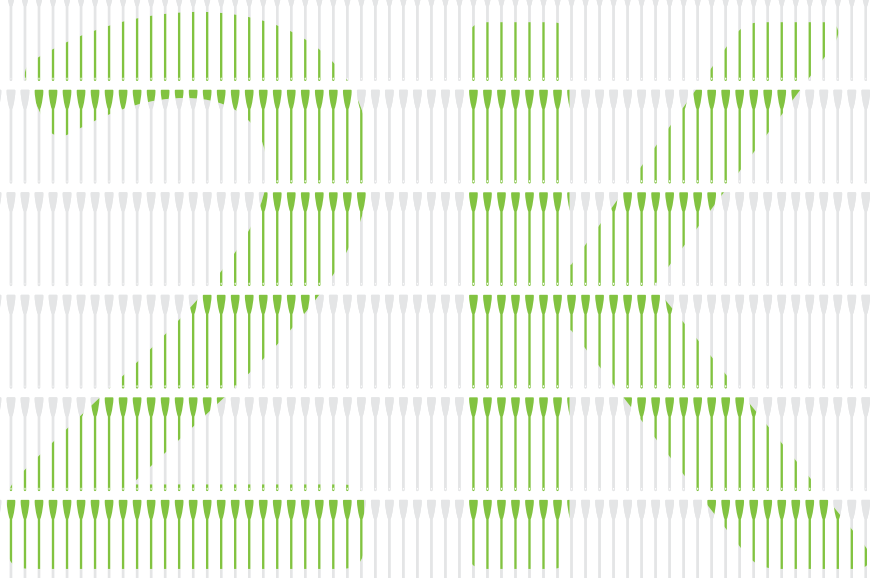

Se seus pacientes usam cateteres quatro a seis vezes ao dia...




...isso é mais de 2.000 vezes por ano!¹

Baseado em um levantamento quantitativo entre 200 usuários de cateter intermitente do sexo masculino com lesões na medula espinal realizado em 2017, o tempo médio gasto pelos indivíduos por autocateterização são 11 minutos, o que representaria mais de 365 horas por ano abrindo embalagens, inserindo cateteres e descartando o cateter e a embalagem quando terminam.²

Quais problemas os pacientes podem enfrentar durante a auto-cateterização?

Complexo




Usar um cateter quatro a seis vezes ao dia pode exigir vários passos para realizar a cateterização. Isso realmente impacta todos os aspectos da vida de qualquer pessoa. Algumas vezes pode levar à infecção e irritação em alguns usuários.

Doloroso



Apesar da autocateterização intermitente ter se tornado o padrão de tratamento, alguns pacientes podem sentir dor e desconforto.

Difícil

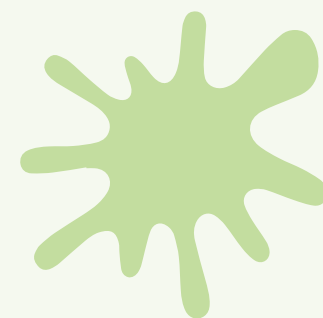

Alguns pacientes têm que lidar com a dificuldade de lubrificar e hidratar os cateteres quando realizam a cateterização até 2.100 vezes por ano.

Esses problemas podem contribuir para a não adesão do paciente às prescrições para uso do cateter.

Estudos mostraram que experiências positivas para o paciente ajudam na adesão ao tratamento prescrito.^{3,4}


O cateter hidrofílico MAGIC³ Go[™] oferece controle, conforto e praticidade ao paciente.

Controle



Os cateteres intermitentes hidrofílicos MAGIC³ Go[™] são fáceis de manusear e eliminam a necessidade de tocar na superfície do cateter.

Conforto

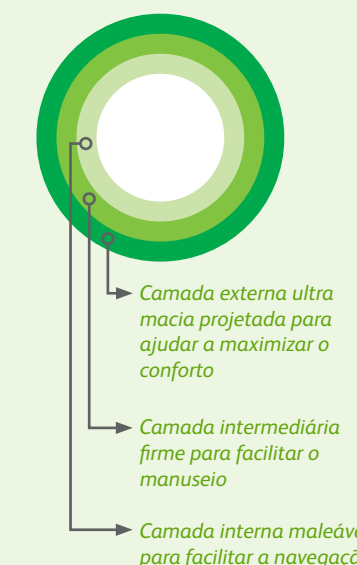

Nosso cateter com três camadas de silicone foi projetado para deslizar fácil e confortavelmente pelo trato urinário. Em testes pré-clínicos, os cateteres intermitentes hidrofílicos MAGIC³ Go[™] mostraram exigir duas a três vezes menos força para inserir/remover comparado com produtos concorrentes testados.

Dados pré-clínicos podem não corresponder aos resultados em humanos.

Confiança



É fácil de carregar, fácil de abrir e fácil de usar para os seus pacientes (embalagem discreta e dobrável e com revestimento inovador que não requer fluidos ou lubrificação antes da inserção). Seus pacientes podem carregar vários cateteres dobrados de forma compacta durante todo o dia. Sua tecnologia com revestimento auto-hidratante mantém o cateter hidratado, não precisando de nenhuma intervenção do paciente. Sem água, sem lubrificante, significa SEM COMPLICAÇÃO OU DIFICULDADE.

MAGIC³ Go[™]

CATETER INTERMITENTE com Tecnologia CLEANGLIDE[™]

Sendo a primeira família de cateteres hidrofílicos desse tipo, o MAGIC³ Go[™] oferece várias opções para o uso diário, incluindo cateteres **masculino ponta reta e coude, feminino e pediátrico.**

CATETER INTERMITENTE com Tecnologia CLEANGLIDE™

Informações para Pedido

	Código do Item	Tamanho CH/ Fr	Comprimento	Tipo de Ponta
Comprimento dos cateteres masculinos 40 cm	53810G	10 Fr	16" (40 cm)	Reta
	53812G	12 Fr	16" (40 cm)	Reta
	53814G	14 Fr	16" (40 cm)	Reta
	53816G	16 Fr	16" (40 cm)	Reta
	53818G	18 Fr	16" (40 cm)	Reta
	53820G	20 Fr	16" (40 cm)	Reta
	50810G	10 Fr	16" (40 cm)	Coude
	50812G	12 Fr	16" (40 cm)	Coude
	50814G	14 Fr	16" (40 cm)	Coude
	50816G	16 Fr	16" (40 cm)	Coude
50818G	18 Fr	16" (40 cm)	Coude	

Anvisa: 80689090171

Comprimento dos cateteres pediátricos 25 cm	52806G	6 Fr	10" (25 cm)	Reta
	52808G	8 Fr	10" (25 cm)	Reta
	52810G	10 Fr	10" (25 cm)	Reta

Anvisa: 80689090171

Comprimento dos cateteres femininos 15 cm	51808	8 Fr	6,4" (15 cm)	Reta
	51810	10 Fr	6,4" (15 cm)	Reta
	51812	12 Fr	6,4" (15 cm)	Reta
	51814	14 Fr	6,4" (15 cm)	Reta
	51816	16 Fr	6,4" (15 cm)	Reta
	51818	18 Fr	6,4" (15 cm)	Reta

Anvisa: 80689090170

Para mais informações sobre o cateter intermitente MAGIC³ Go™ favor contatar seu representante de vendas local ou visite o site www.bd.com.


Os cateteres intermitentes são usados para drenar urina da bexiga. Reutilizar um dispositivo para uso único pode levar ao risco de infecção para o paciente ou usuário. Favor consultar os rótulos e bulas dos produtos para informações de segurança mais detalhadas e instruções de uso.

1. Newman, D.K. and M.M. Willson, Review of intermittent catheterization and current best practices. Urol Nurs, 2011. 31(1): p. 12-28, 48.
2. BD, "ISC user experience research among 200 male spinal cord injury patients", 2017. Data on file.
3. Logan, K., The male experience of ISC awith a silicone catheter. Br J Nurs, 2015. 24(9): Urology Supplement.
4. Logan, K., The female experience of ISC with a silicone catheter. Br J Nurs, 2017. 26(2): p. 82-88.

BD Interventional

Rua Alexandre Dumas, 1976 - São Paulo - SP - 04717-004 - 0800 771 7157

www.bd.com | www.bardcare.com

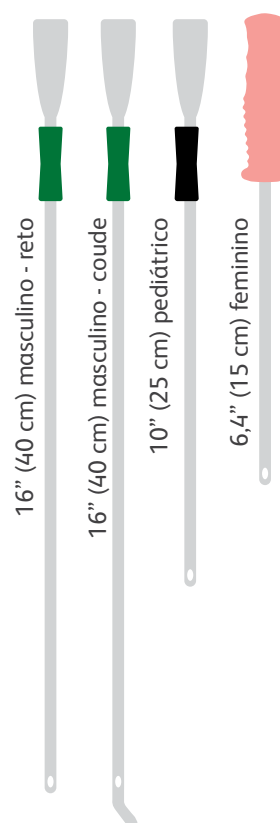

Não é feito com látex de borracha natural, DEHP e/ou ftalatos.

